

## کاربرد نانوسنسورهای گرافنی در توالی سنجی DNA

### خلاصه

تلاش برای کشف مشخصه‌های گوناگون سیستم‌های زیستی مهم‌ترین محرك توسعه تحقیقات در زمینه علوم پزشکی و زیست‌مولکولی به حساب می‌آید. آنالیز سریع، حساس، دقیق و مقرن‌به‌صرفه مولکول‌های زیستی اهمیت ویژه‌ای در تشخیص و درمان‌های بالینی دارند. پیشرفت‌های اخیر در تکنولوژی توالی سنجی DNA سبب تحول گسترده‌ای در علوم و تحقیقات زیستی-پزشکی شده است. با پیدایش و توسعه نانومواد، استفاده از این ساختارها در آشکارسازی مولکول‌های زیستی و تشخیص ساختارهای آن‌ها مطرح و مورد توجه واقع شده است. پیدایش گرافن به عنوان یک نانوماده جدید دارای ساختار کربنی با ضخامت تک‌اتم به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد الکترونی، مکانیکی، حرارتی و اپتیکی، افقی جدید در تحقیقات علوم مختلف زیستی-پزشکی و تولید بیوسنسورهای آنالیز زیست‌مولکول‌ها گشوده است. در این مقاله به مروری بر توسعه نانوسنسورهای گرافنی و کاربرد آن‌ها در توالی سنجی DNA اشاره می‌شود.

افسان شیرکوند ۱۹۲

محمد اسماعیل زیبایی<sup>۳</sup>

۱. گروه لیزر پزشکی، مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی، جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
۲. دانشجوی دکتری فوتونیک، پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی
۳. استادیار فوتونیک، پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده مسئول: افسان شیرکوند، تلفن: ۰۶۶۴۹۲۵۷۲  
پست الکترونیک: a\_shirkavand@sbu.ac.ir

واژه‌های کلیدی: توالی سنجی DNA، نانوسنسور، گرافن

## مقدمه

بودن اطلاعات توالی‌سننجی DNA و ژن‌ها برای پیش‌بینی، تشخیص سرطان و انتخاب درمان بهینه برای بیماران دلالت دارند [۷].

### روش‌های توالی‌سننجی DNA:

نسل اول<sup>۲</sup> یا روش‌های کلاسیک- توالی‌سننجی از دهه ۱۹۷۰ هنگامی که اولین روش‌های آنژیمی آنالیز مولکول‌های بیولوژیکی معرفی شدند، شروع گردید. این روش‌های توالی‌سننجی بر پایه آزمایشات شیمیایی، آنژیمی و غیر آنژیمی استوار بودند. اگرچه تکنولوژی Sanger در این نسل به مدت حدود ۳۰ سال ابزار تحقیقات توالی‌سننجی بود [۵]، اما به دلیل توان عملیاتی محدود و هزینه بالای این روش‌ها انجام مطالعات زیاد میسر نشد [۷]. پس از نسل اول یا توالی‌سننجی کلاسیک، تکنولوژی‌های نوین به عنوان نسل جدید (NGS)<sup>۳</sup> توالی‌سننجی گسترش یافتند [۱۸]. روش‌های نوظهور نسل دوم نیز عمدتاً بر پایه آزمایشات شیمیایی بنا نهاده شده بودند که قابلیت آنالیز دقیق مولکول‌های DNA تکرتهای و ژنوم در این مرحله را سبب شدند [۹ و ۱۸]. توسعه این روش‌های سریع، دقیق و با توان عملیاتی بالاتر سبب کاهش قابل ملاحظه هزینه در این سال‌ها گردید که با توجه به تقاضای روزافزون برای بهره‌بردن از ظرفیت‌های توالی‌سننجی در تشخیص بیماری‌ها و نقایص ژنتیکی مزیت این روش‌ها به حساب می‌آمد [۱، ۹ و ۱۹]. جهت کاهش هزینه توالی‌سننجی DNA و افزایش چشمگیر دقت و سرعت توالی‌سننجی، نسل سوم توالی‌سننجی<sup>۴</sup> به صورت سنتورها و ریزترانشهای با به کارگیری روش‌های فیزیکی توسعه یافته‌اند [۵]. مهم‌ترین مزیت نسل سوم روش‌های توالی‌سننجی، توانایی آشکارسازی تکمیل‌کارهای و جفت‌بارهای نوکلئوتیدی DNA بدون نیاز به تقویت کلونال و فرآیندهای شیمیایی قبل از زمان انجام توالی‌سننجی می‌باشد [۹ و ۲۱]. این مزیت در مقایسه با روش‌های دو نسل قبلی به دلیل نیاز کمتر به دست‌کاری نمونه DNA که باید توالی آن‌ها خوانده شوند، سبب کاهش اختلال و خطأ در فرآیند توالی‌سننجی می‌شود [۹]. به علاوه، نسل‌های قبلی توالی‌سننجی بر پایه سنترهای شیمیایی بود در حالی که تکنیک‌های آشکارسازی نسل سوم عمدتاً تشخیص فیزیکی بازهای نوکلئوتیدی در نمونه‌های DNA به صورت دستکاری نشده را ممکن ساخته است [۱۸]. توالی‌سننجی نسل سوم شامل روش‌هایی از قبیل توالی‌سننجی در زمان واقعی تکمیل‌کار<sup>۵</sup>، توالی‌سننجی در زمان واقعی با استفاده از انتقال انرژی تشدید فلورسانس<sup>۶</sup>، تصویربرداری DNA مستقیم توسط میکروسکوپ الکترونی<sup>۷</sup>، تصویربرداری مستقیم از DNA توسط پروب‌های میکروسکوپ تونل‌زنی رویشی<sup>۸</sup>، نانوپورها<sup>۹</sup>، ترانزیستورها<sup>۱۰</sup> و پروب‌های لیه چاقو<sup>۱۱</sup> می‌باشد.

تمایل به افزایش دانسته‌ها در زمینه حقایق زندگی موجودات زنده و ویژگی‌های آن، کلید اصلی تحقیقات علمی و توسعه تکنولوژی‌های مرتبط با آن است. این تحقیقات منجر به کشف واقعیت‌هایی در مقایسه مولکولی نظیر مولکول‌های پروتئین، اسیدهای نوکلئیک (DNA) و ژن‌ها که حاوی اطلاعات حیاتی برای عملکرد سلولی ارگانیسم‌های زنده هستند، شده است. به دلیل نقش کلیدی اسیدهای نوکلئیک، تحقیقات عظیمی برای شناسایی جزئیات ساختاری و عملکردی DNA از گذشته تاکنون انجام پذیرفته است. در دو دهه اخیر، ابزارها و تکنولوژی‌ها توسعه چشمگیری داشته‌اند [۱-۴]. تکنولوژی‌های نوین توالی‌سننجی DNA افق علمی روشنی را پیش روی محققان علوم زیستی نهاده و سبب ارتقای ظرفیت تحقیقات پزشکی - زیستی و تجزیه و تحلیل زیست‌مولکول‌ها گردیده است [۴ و ۵].


### توالی‌سننجی DNA:

با شروع پروژه ژنوم انسانی<sup>۱</sup> که انقلابی علمی در تحقیقات پایه‌ای- کاربردی علوم پزشکی به حساب می‌آید [۱]، تلاش برای استخراج نقشه ژنتیکی، سبب شناسایی تعداد زیادی ژن و باز نوکلئوتیدی (حدود ۳ بیلیون) شده است [۶ و ۷]. مهم‌ترین روش استخراج نقشه ژنتیکی، توالی‌سننجی رشته‌های DNA می‌باشد [۸]. توالی‌سننجی مولکول DNA، فرآیندی است که در آن ترتیب بازهای نوکلئوتیدی تشکیل‌دهنده هر رشته مشخص از DNA از طریق آشکارسازی خصوصیات ویژه فیزیکی، الکتریکی، نوری و مغناطیسی این بازها تعیین می‌شود [۵]. محدوده وسیعی از تحقیقات پزشکی در زمینه مطالعات سرطان [۹ و ۱۲]، تشخیص ژنتیکی [۱۰ و ۱۱]، ویروسی- میکروبی [۱۲] و بیوتکنولوژی [۱۳] از توالی‌سننجی DNA بهره می‌برند. پیشرفت‌های متداول‌تریک در توالی‌سننجی سبب تغییر شیوه آنالیز کردن اطلاعات ژنتیکی توسط دانشمندان و افزایش اطلاعات حاصل شده است [۹]. در علوم پزشکی این سطح از اطلاعات، اساس پاتولوژیست‌ها را نیز تغییر داده است. در حال حاضر پاتولوژیست‌ها با کمک تکنولوژی‌های توالی‌سننجی قادر به آنالیز، تشخیص و ردیابی محل جهش‌ها و یا تغییرهای ژنتیکی نوع خاص بیماری افراد با دقت قابل قبولی می‌باشند [۹ و ۱۴]. در زمینه DNA تشخیص‌های پیش از تولد، پیشرفت در زمینه توالی‌سننجی به توسعه روش‌های متعدد پیشگیری، تشخیص و غربالگری جنینی و مشاوره ژنتیکی مورد نیاز برای بیماری‌ها منجر شده است [۱۵ و ۱۶]. در زمینه بیماری سرطان تجربیات به دست آمده در این سال‌ها بر مفید

- |                                         |                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Human Genomic project (HGP)          | 6. Real-Time DNA sequencing using fluorescence resonance energy transfer    | 9. nanopores                              |
| 2. 1st generation sequencing            | 7. Direct imaging of DNA using electron microscopy                          | 10. Transistor-mediated DNA sequencing    |
| 3. Next Generation Sequencing           | 8. Direct imaging of DNA sequences using scanning tunneling microscope tips | 11. Nano-Knife-Edge Probes for Sequencing |
| 4. Third Generation Sequencing          |                                                                             |                                           |
| 5. Single-molecule real-time sequencing |                                                                             |                                           |

انجام می‌شود. شدت تابش فلورسانس به قدرت برهمکنش بیومولکول‌ها در سنسور ارتباط داده می‌شود و آنالیزها بر این اساس انجام می‌گیرند. بالعکس، در روش غیرنشان‌دار، مولکول‌ها به شکل اصلی خود و بدون برچسب خودرن یک رنگدانه مورد آشکارسازی قرار می‌گیرند. این نوع از آشکارسازی نسبتاً آسان، ارزان و برای انجام آنالیزها در زمان واقعی و بررسی کینتیک<sup>۱۶</sup> برهمکنش‌های بیومولکول‌ها مناسب است. در جدول ۱ براساس تکنولوژی برخی از بیوسنسورهای نوری، خصوصیات اپتیکی و محدوده آشکارسازی آن‌ها به تفصیل معرفی شده است که از این میان می‌توان به تداخل‌سنجهای، موجبر نوری<sup>۱۷</sup>، ریزتراسه‌ها<sup>۱۸</sup> و فیبرهای نوری<sup>۱۹</sup> اشاره نمود [۲۹ و ۳۰].

در سال‌های اخیر، تحقیقات بسیار زیادی در زمینه ساختارهای نانوکربنی صورت گرفته است. لذا، این دسته از نانومواد قابلیت استفاده در نانو بیوسنسورهای اپتیکی را دارا می‌باشند. از انواع مختلف ساختارهای نانوکربنی به نانوتیوب‌ها، نانودات‌ها و ساختار سه‌بعدی گرافیت می‌توان اشاره نمود (شکل ۱). جدیدترین ساختار نانوکربنی گرافن می‌باشد که در شکل ۱ نشان داده شده است. گرافن یک ساختار دو بعدی نازک از حلقه‌های شش‌اتمی کربن است که تشکیل یک شبکه اتمی هگزاگونال<sup>۲۱</sup> که به طور قوی بهم پیوند خورده‌اند را می‌دهد. از ویژگی منحصر به فرد گرافن می‌توان به حالت هیبریداسیون SP2 و ضخامت بسیار نازک اتمی آن (از مرتبه چندصد نانومتر) اشاره نمود [۳۰].

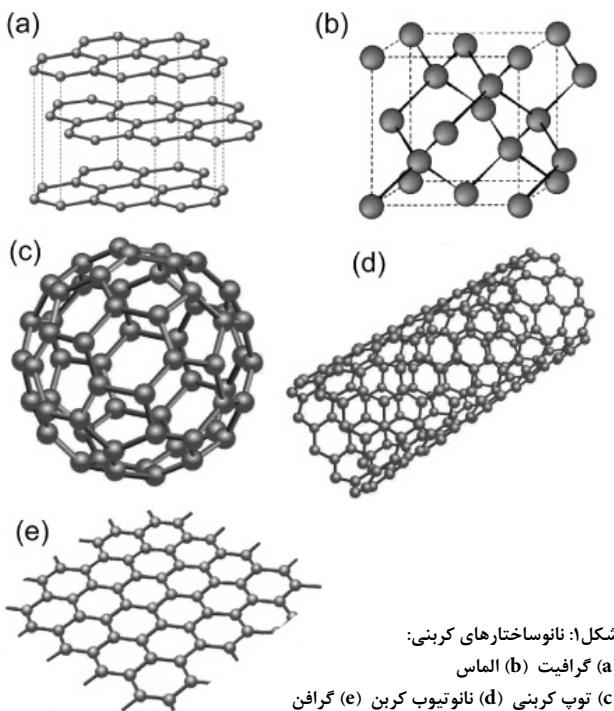

12. Field effect transistor; FET  
 13. Bio-optical nanosensors  
 14. fluorescence-based detection

15. label-free detection  
 16. fluorophore  
 17. Kinetic

### نانو سنسورهای گرافنی:

با پیدایش دانش نانوتکنولوژی و معرفی انواع مختلف نانومواد با داشتن ابعادی در مقیاس بسیار کوچک نانومتر، طراحی، ظهور و تجارت‌سازی تحقیقات علوم مختلف بیولوژی، فیزیک، شیمی، پزشکی و ... دچار تحولی چشمگیر گردید [۲۲]. پیشرفت و کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت تولید دارو و علم پزشکی، آینده این علوم را تغییر داده است و پتانسیلهای موجود در این زمینه محققان عرصه پزشکی و داروسازی را بیش از پیش قادر به ترکیب و تولید نانو سوزرات برای تولید مولکول‌های دارویی اختصاصی‌تر برای درمان مؤثرتر بسیاری از بیماری‌ها همچون سرطان نموده است [۲۴ و ۲۲]. با استفاده از تکنولوژی نانو، عصر جدیدی از توسعه سنسورها برای آنالیز مواد در مقیاس‌های بسیار کوچک نانو که در گذشته غیر ممکن بود، آغاز گردید [۲۵ و ۲۲]. بیوسنسورها تجهیزاتی هستند که براساس برهمکنش ویژه فیزیکی-شیمیایی سبب آشکارسازی و تجزیه و تحلیل عناصر بیولوژی و بیوشیمیایی در نمونه‌های زیست-پزشکی می‌شوند [۲۶]. این بیوسنسورها براساس فرآیند برهمکنش آشکارسازی و تکنیک آشکارسازی به چند گروه از قبیل: ۱- بیوسنسورهای تشدیدی، ۲- بیوسنسورهای اپتیکی، ۳- بیوسنسورهای حرارتی، ۴- بیوسنسورهای ترانزیستورهای اثر میدان  $^{12}\text{FET}$  و ۵- بیوسنسورهای الکتروشیمیایی تقسیم می‌شوند. از زمان پیدایش بیوسنسورها به دلیل ارتقای حساسیت و دقت این دسته از تجهیزات افزایش کاربری آن‌ها همواره رو به افزایش گزارش شده است [۲۶ و ۲۷]. نانومواد جدید به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد شیمیایی، فیزیکی، اپتیکی، الکترونیکی و مقیاس اندازه بسیار کوچک نانومتری برای استفاده و توسعه بیوسنسورها و اندازه‌گیری‌های بیولوژیکی بسیار سازگار، ایدئال و مقرن به صرفه هستند [۲۵]. ترکیب نانوتکنولوژی، بیولوژی مولکولی و فوتونیک امکان منحصر به فردی را برای گسترش تجهیزات بیونانو سنسورهای اپتیکی<sup>۱۳</sup> با قابلیت کاربری در محدوده وسیعی از آشکارسازهای تشخیصی و درمانی برای محققان فراهم آورده است [۲۵ و ۲۶]. رشد نانو سنسورهای نوری برای آنالیز سلول‌ها و مولکول‌های زیستی-بیوشیمیایی به این‌باره بسیار دقیق و سریعی که هم‌اکنون در بسیاری از مطالعات پایه و کاربردی علوم بهداشتی، بیولوژی سلولی، پزشکی و کشف داروها در حال استفاده است، تبدیل شده‌اند [۲۶ و ۲۸]. دو روش اصلی آشکارسازی در بیوسنسورهای اپتیکی عبارت‌انداز: آشکارسازی بر پایه تابش فلورسانس<sup>۱۴</sup> و آشکارسازی بدون نشانه‌گذاری<sup>۱۵</sup> [۲۸ و ۲۹]. در آشکارسازی نشان‌دار بر پایه تابش فلورسانس، مولکول‌های هدف یا مولکول‌هایی که باید آشکارسازی شوند، توسط پروتئین‌های فلورسانس (رنگدانه<sup>۱۶</sup>) نشان‌دار می‌شوند و به واسطه برهمکنش این مولکول‌های نشان‌دارشده در نانو سنسور، تابش فلورسانس

21. honeycomb

محدودیت آشکارسازی	آنالیز	خصوصیات اپتیکی	پایگاه تکنولوژی (Technology Platform)
$10^{-5}$ - $10^{-8}$ RIU $10^{-7}$ - $10^{-8}$ RIU 0.1nM 0.2nM 1.3Nm 10 pM 0.15 ng mL <sup>-1</sup> 106 cfumL <sup>-1</sup>	Bulk solution Bulk solution پروتئین پروتئین پروتئین DNA پروتئین باکتری	- رزونانس پلاسمون سطحی - محدوده وسیع رزونانس پلاسمون سطحی - تصویربرداری براساس رزونانس پلاسمون سطحی - ترکیب اپتیکی رزونانس پلاسمون سطحی - رزونانس پلاسمون سطحی حساس به فاز - رزونانس پلاسمون سطحی طول موج مدوله شده - رزونانس پلاسمون سطحی زاویه مدوله شده - رزونانس پلاسمون سطحی بر پایه منشور	رزونانس پلاسمون سطحی
25 cfumL <sup>-1</sup> 20 pgmm <sup>-2</sup> 1000 particle mL <sup>-1</sup> 4 ngmL <sup>-1</sup> Protein 5ngmL <sup>-1</sup> 2pM 0.1 ngmL <sup>-1</sup> femto-mole/ pico-mole	باکتری پروتئین ویروس DNA پروتئین DNA پروتئین پروتئین	BIAcore 2000 SPR Mach-Zehnder Young's interferometer Hartman interferometer Porous silicon BioCD Microchannel	تداخل سنج
$\sim 0.1$ pgmm <sup>-2</sup> 106 cellsmL <sup>-1</sup> $\sim 105$ sporesmL <sup>-1</sup> $\sim 10$ cellsmm <sup>-2</sup> 60 cellsmm <sup>-2</sup> $2 \times 10^{-7}$ RIU	پروتئین سلول سوس باکتری سلول سلول Bulk solution	آینه رزونانسی پوشش کلد فلزی تقارن معکوس کلد فلزی مقارن	موج بر
$\sim 100$ nM 60-250 pgmm <sup>-2</sup> 1 pgmm <sup>-2</sup> 10 pgmL <sup>-1</sup> $\sim 1$ pgmm <sup>-2</sup> pgmm <sup>-2</sup> , 10pM $\sim 1$ pgmm <sup>-2</sup> , 3pM	DNA پروتئین DNA پروتئین ویروس/باکتری DNA پروتئین	حلقه بربوری ریزتراسه میکروکره دی الکتریک حلقه اپتیکی-فلوئیدی بر پایه لوله موئین	رزوناتور حلقوی
0.7_gmL <sup>-1</sup> , 0.1_M 2_gmL <sup>-1</sup> 10 <sup>-7</sup> RIU 0.5_gml <sup>-1</sup> 76_M, 1.7 ng 25_gmL <sup>-2</sup>	DNA پروتئین Bulk solution پروتئین DNA پروتئین	توري برآگ با تناوب کوتاه توري برآگ با تناوب بلند نانوفیبر نوری کوپلر فیبر نوری کاواک فابری-پرو فیبر نوری	فیبر نوری
0.4 pgmm <sup>-2</sup> 1 fg 0.15_M $7 \times 10^{-5}$ RIU	پروتئین پروتئین پروتئین Bulk solution	فوتونیک کریستال دو بعدی میکروکاواک فوتونیک کریستالی دو بعدی موجر فوتونیک کریستالی آرایه میکروکاواکی فوتونیک کریستال یک بعدی	فوتونیک کریستال

رسانش الکترونی ماده کاملاً پایین است، اما سطح فرمی<sup>۲۸</sup> می‌تواند با ناخالص‌سازی ماده (با الکترون‌ها و حفره‌ها) تغییر داده شود به طوری که ماده در دمای اتاق به طور بالقوه دارای هدایت الکترونی بهتر از مس شود [۳۴ و ۳۵].

از نظر فوتونیکی به این دلیل که در دمای اتاق حامل‌های بار الکتریکی گرافن فرمیون‌های دو بعدی دیراک با جرم مؤثر صفر و سرعتی در حد سرعت نور، تحرک پذیری ذاتی قوی دارند، (آزادی حرکتی برابر  $1\text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$ ) می‌توانند مسیرهای طولانی را بدون پراکندگی طی کنند. گرافن خواص نوری متنوعی را به نمایش می‌گذارد که از جمله آن می‌توان به رسانایی نوری ثابت در محدوده مادون قرمز و جذب نوری قابل کنترل اشاره نمود. گرافن ثابت هدایت جهانی نوری به اندازه نوری  $G = \pi e^2/4\hbar$  دارد [۳۱ و ۳۴]. در محدوده نور مرئی فیلم‌های گرافنی نازک دارای شفافیت هستند. به عبارت دیگر، کدری گرافن به صورت محاسبه می‌شود که  $a^{29} \approx 2.3\%$  است. این شفافیت نوری فرکانسی مرئی تا مادون قرمز  $\approx 2.3\%$  است. گرافن با افزایش ضخامت به طور خطی کاهش پیدا می‌کند (برای یک فیلم نازک ۲ نانومتری شفافیت نوری برابر ۹۵ درصد است اما، برای ضخامت ۱۰ نانومتر به کمتر از ۷۰ درصد کاهش پیدا می‌کند). مجموع این ویژگی‌ها استفاده فیلم‌های گرافن با ضخامت گوناگون را برای تولید و توسعه قطعات و تجهیزات فوتونیکی قابل کنترل مختلف از جمله ایزو لاتورها، مدولاتورها، دتکتورهای نوری، ژنراتورهای امواج تراهنر، دتکتورهای امواج تراهنر، لیزرهای حالت جامد و ... مناسب می‌سازد [۳۱ و ۳۴، ۳۷].

### پروپهای گرافنی مورد استفاده در توالی سنجی DNA:

گرافن به دلیل ویژگی‌های ساختاری که در بخش قبل به آن‌ها اشاره شد، پتانسیل مناسبی را برای استفاده در کاربردهای بیولوژیکی فراهم آورده است. خلوص شیمیابی، سطح وسیع، عامل دار کردن آسان این سطح و هزینه پایین تولید مقابله زیاد فیلم‌های گرافنی، کاربرد این ماده را در ساخت نانوبیوسنسورهای اپتیکی و دارورسانی افزایش داده است [۳۱ و ۳۸]. گرافن یا مشتقات گرافنی مانند گرافن اکساید و یا گرافن اکساید احیاء شده که ترکیبات کربنی محلول در آب هستند برای بیوسنسورها و پلات فرم‌های اپتیکی قابل کاربرد در تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی مولکول‌های زیستی و بیوشیمیابی ایدئال هستند [۳۹ و ۳۸]. تحقیقات مختلفی سازگاری زیستی گرافن و گرافن اکساید را برای سلول‌های میکروارگانیسم‌های زنده نشان داده‌اند. براساس آزمایش‌های کشت سلولی انجام شده، از آنجاکه ورقه‌های گرافنی، زیست‌سازگار و دارای سمیت ناچیزی هستند، برای کاربردها

ورقه‌های گرافن دارای مشخصات ویژه حرارتی، الکتریکی، مکانیکی و اپتیکی می‌باشند [۳۰-۳۵]. پیش از سال ۲۰۰۴، از نظر تئوری دانشمندان بر این اعتقاد بودند که ترکیب‌های دو بعدی بدليل عدم پایداری حرارتی به هنگام جداسازی نمی‌توانند وجود داشته باشند. اما، با جداسازی گرافن این امر ممکن گردید و دانشمندان به چگونگی آن بی بردن. پس از اینکه ورقه‌های معلق گرافن به وسیله میکروسکوپ الکترونی عموری بررسی شد، دانشمندان دلیل آن را ناشی از ناهمواری<sup>۲۲</sup> اندک گرافن در اثر اصلاح ساختار ماده اعلام کردند. با این حال، تحقیقات بیشتر نشان داد که پایداری حرارتی گرافن ناشی از پیوندهای بین مولکولی قوی کربن-کربن این ماده است که سبب جلوگیری از نوسانات حرارتی آن می‌شود [۳۱ و ۳۲]. یک خصوصیت دیگر گرافن، قدرت ذاتی این ماده به دلیل قدرت پیوندهای کربنی آن است. به همین دلیل از گرافن با استحکام کششی نهایی ۱۳۰ گیگا پاسکال به عنوان ماده‌ای قوی یاد می‌شود [۳۶]. مشخصه دیگری که گرافن را ویژه می‌کند این است که گرافن خصوصیات الاستیک دارد که آن را قادر می‌سازد اندازه اولیه خود را پس از اعمال فشار حفظ نماید. در سال ۲۰۰۷ آزمایش‌های میکروسکوپ نیروی اتمی<sup>۲۳</sup> که بر روی ورقه‌های گرافن برروی حفره‌های سیلیکون دی‌اکسید انجام گرفت نشان داد که ورقه‌های گرافنی (با ضخامت ۲-۸ نانومتر) ثابت نمودند [۳۶].

خصوصیت الکترونیکی ویژه گرافن به دلیل رسانایی الکتریکی بالای گرافن به دلیل همپوشانی صفر نیمه‌فلز آن (حامل‌های بار الکترون و حفره) است. اتم‌های کربن در مجموع شش الکترون دارند که دو الکترون در لایه داخلی و چهار الکترون در لایه خارجی قرار گرفته است. چهار الکترون لایه خارجی در اتم کربن از نظر پیوند شیمیابی برقرار کردن در دسترس هستند. اما، در گرافن هر اتم به سه اتم کربن دیگر در صفحه دو بعدی گرافن متصل است لذا یک الکترون آزاد در بُعد سوم برای هدایت الکترونی وجود دارد. این الکترون‌های بسیار متحرک الکترون‌های پی (π) نامیده شده و در قسمت بالا و پایین ورقه گرافن قرار گرفته‌اند. اریتال‌های π با هم همپوشانی دارند و این امر سبب بهتر شدن پیوندهای کربن-کربن گرافن می‌شود. اساساً ویژگی‌های الکترونی گرافن توسط پیوند و ضدپیوند<sup>۲۵</sup> (پیوندهای والانس و هدایت) اریتال‌های π ایجاد می‌شود. مطالعات ترکیبی در چند دهه گذشته اثبات کرده‌اند که در نقطه دیراک در گرافن، الکترون‌ها و حفره‌ها جرم مؤثر صفر دارند. این به دلیل رابطه خطی انرژی-حرکت (طیف تحریک) برای انرژی‌های پایین در نزدیکی منطقه بریلون<sup>۲۶</sup> است. این الکترون‌ها و حفره‌ها فرمیون‌های دیراک<sup>۲۷</sup> نامیده می‌شوند. به دلیل دانسیتیه صفر این حالت‌ها در نقاط دیراک

22. Rippling

23. Atomic force microscopic (AFM)

24. Young's modulus


25. anti-bonding

26. Brillouin zone

27. Dirac fermions

28. Fermi level

29. fine-structure constant

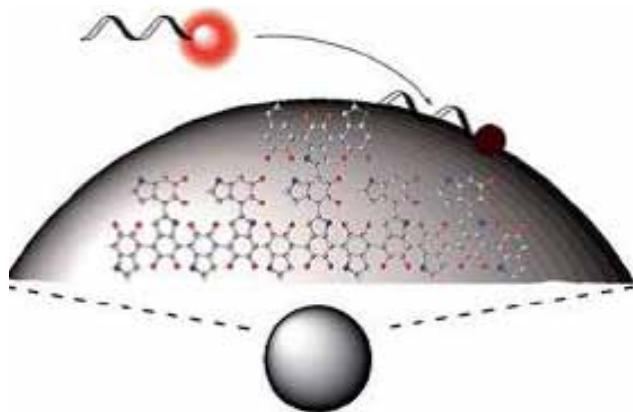


شکل ۲: شماتیک از مکانیسم خاموش شدن فلورسانس تکرشتة DNA در پروب گرافنی توالی سنجی DNA [۴۱]

در این پروبها می‌توان به مواردی همچون آمینومتیل کورامین استات (AMCA)<sup>۳۱</sup>، کربوکسی فلورسین (FAM)<sup>۳۲</sup>، سیانین فایو<sup>۳۳</sup> و کربوکسی ایکس رودامین (ROX)<sup>۳۴</sup> اشاره نمود که با تابش لیزرهایی با محدوده طول موجی آبی (۴۹۴ نانومتر)، قرمز (۶۴۳ نانومتر) و یا نارنجی (۵۸۷ نانومتر) به حالت تحریک در می‌آیند. در مطالعه‌ای که با پروب فلورسانسی گرافن براساس تشخیصی فلورسانس برهمنکش هیدروفوبیک تکرشتة DNA برای توالی سنجی DNA انجام شده است، در آشکارسازی هدفهای DNA در یک محلول نمونه هموژن با بهره‌برداری از برهمنکش GO-DNA، عملکرد سیستم هدف-پروب<sup>۳۵</sup>

و تجهیزات سنسورهای مورد استفاده در آنالیزهای زیست-پزشکی از جمله نمونه‌های بیوشیمی خون مانند اندازه‌گیری قند، کلسترول، هموگلوبین خون و بافت‌شناسی گزینه مناسبی می‌باشد [۴۰]. همچنین این بیوسنسورهای اپتیکی به دلیل آسانی فرآیند عامل‌دار کردن گرافن نسبت به موارد مشابه، جهت انجام آزمایش‌های اندازه‌گیری سیار حساس، از سرعت بالاتری برخوردارند. حساسیت، انتخابی بودن و مقرر به صرفه بودن سبب استفاده از مشتقات گرافن در تولید ابزارهای آنالیز و اندازه‌گیری فوق سریع بیومولکول‌ها در تشخیص و درمان پزشکی شده است [۳۸]. در مطالعات DNA، به منظور شناسایی ترتیب قرارگرفتن جفت‌بازهای پورین و پیرimidین (G, A, T, and C) با قدرت تفکیک‌پذیری مناسب و تشخیص نقایص ژنتیکی، ایمنی و یا مطالعات موتاسیون ژنتیکی بیماری‌های مختلف، استفاده از بیوسنسورهای گرافنی بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است [۳۸].

دسته‌ای از نانوپلاتفرم‌های گرافنی براساس مکانیسم نشان‌دار کردن مولکول‌های هدف بهوسیله مولکول‌های پروتئین فلوروفور و برهمنکش‌هایی بر پایه تابش فلورسانس عمل می‌کنند. در این مکانیسم لایه گرافنی مانند یک خاموش‌کننده<sup>۳۰</sup> عمل می‌کند (شکل ۲). بدین معنی که در برهمنکش ماده فلوروفور یا بیومولکول ssDNA نشان‌دارشده با فلوروفور (مانند تکرشتة نوکلئیک اسید و گرافن، انرژی از ماده نشان‌دار به گرافن انتقال می‌یابد و تابش فلورسانس خاموش و یا باشد ناچیز انجام می‌شود [۴۱ و ۴۲]). از انواع مختلف مولکول‌های نشان‌دار کننده با فلوروفور مورد استفاده

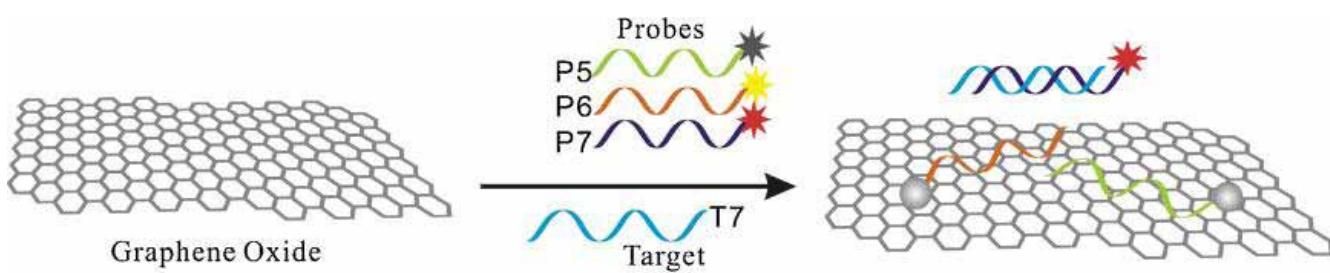

شکل ۳: شماتیک از آنالیز DNA نشان‌دار شده با مولکول‌های فلوروفور [۴۲]

30. Quencher


31. Aminomethylcoumarinacetate (AMCA)

32. 6-carboxyfluorescein (FAM)

33. Cyanine 5

34. 6-carboxy-X-rhodamine(ROX)

شتاپدار ( $300\text{ kV}$ ) وجود دارد. هنگامی که این بمباران الکترونی در دمای اتاق انجام می‌پذیرد، سبب بهمریختگی و نامنظم شدن شکل نانوپور گرافنی می‌شود. برای رفع این نقص، پیشنهاد شده است که بمباران باریکه الکترونی صفحه گرافنی در دمای بالای  $500$  درجه سانتی گراد انجام پذیرد [۴۵].

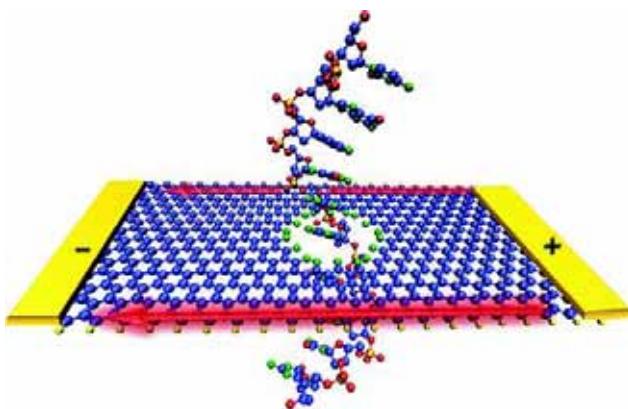

شکل ۴: شماتیک از پروب نانوپور گرافن در توالی سنجی DNA

در پروب‌های نانوپور گرافن، جریان عرضی<sup>۴۰</sup> با استفاده از دو الکترود با ابعاد نانومتر<sup>۴۱</sup> که در عرض روزنه قرار دارند، ثبت می‌شود. با ثبت تغییرات جریان عرضی که حدود چند میکروآمپر است، می‌توان تفکیک پذیری فضایی و زمانی فرآیند آنالیز بیومولکول‌ها را ارتقاء داد [۴۴ و ۴۵]. جریان عرضی ثبت شده توسط الکترودها به‌هنگام عبور DNA به‌ازاء بازهای نوکلئوتیدی مختلف متغیر (شکل ۵) گزارش می‌شود [۴۰ و ۴۵]. براساس تفاوت در جریان می‌توان از روی منحنی‌های وابسته به زمان تغییر شدت جریان عرضی، موقعیت بازهای نوکلئوتیدی را در رشته‌های DNA پیش‌بینی نمود. نتایج مطالعات نشان داده است که پیک جریان عرضی سیتوزین از همه بازهای نوکلئوتیدی دیگر بیشتر است و گوانین کمترین پیک جریان عرضی را سبب می‌شود ( $I_{\text{G}} > I_{\text{T}} > I_{\text{C}} > I_{\text{A}}$ ).

از آنجاکه بازهای نوکلئوتید مجاور با هم در ssDNA برروی جریان‌های نانوپور تأثیرگذار هستند، در نانوپورهای گرافن به‌دلیل خاصیت خاص بسیار نازک گرافن، ابعاد نانوپور در مقایسه با بازهای نوکلئوتیدی رشته DNA قابلیت تمایز بازه‌ها را به‌طور مجزا می‌دهد و اثر برهمکنش تداخلی بازهای مجاور هم تا حد ممکن کاسته می‌شود [۳۰ و ۴۴]. همچنین مطالعات نشان داده‌اند که معمولاً در نانوپورهای گرافنی بعداز چندین ثبت توالی سنجی بازهای DNA به‌دلیل برهمکنش هیدروفوبیک DNA و سطح گرافن نانوپور،

گرافن اکساید (GO) حساس، دقیق و سریع گزارش گردید [۴۲]. هنگامی که ssDNA های پروب نشان‌دارشده با هدف مکمل خود جفت نمی‌شوند و یا به‌طور نادرست<sup>۴۶</sup> جفت می‌شوند (شکل ۳)، خاموش‌شدنگی در اثر انتقال انرژی (و با الکترون تحریک شده) از تکرشهای نشان‌دارشده DNA به GO اتفاق می‌افتد و تابش فلورسانس تضعیف می‌شود. تنها در صورتی که تکرشنده DNA پروب با هدف مکمل خود که توالی بازهای نوکلئوتیدی آن کاملاً مشخص است جفت شود، تابش فلورسانس باشد بالا توسط سیستم سنسور GO قابلیت آشکارسازی چندین مولکول هدف در یک نمونه مورد آزمایش در توالی سنجی DNA وجود دارد [۴۲].

با وجود حساسیت بالای سنسورهای هدف-پروب با استفاده از مولکول نشان‌دار کننده، این سنسورها قابلیت پایش در زمان واقعی را ندارند و بنابراین پیچیدگی غربالگری مواد بیولوژیکی را افزایش می‌دهند [۴۱]. مطالعات دیگری در این زمینه برروی سنسورهای بدون نشان‌دار فیلم‌های GO احیاء شده براساس مکانیسم FET که از میدان الکتریکی برای کنترل هدایت جریان الکتریکی استفاده می‌شود، انجام گرفته است [۴۳]. چالش این سنسورها این است که در فرآیند احیای GO، گروههای عاملی که برای برهمکنش با DNA لازم است به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. بنابراین برای رفع این مشکل، سنسور قبل و بعد از مرحله احیای GO به‌روش شیمیابی، درمعرض سه ماده شیمیابی اتیلن‌دی‌آمین<sup>۳۷</sup>، گلوترال‌دهید<sup>۳۸</sup> و تری‌فلورواتیل‌آمین<sup>۳۹</sup> که لینکرهای مولکولی معمولی هستند، قرار می‌گیرد. با استفاده از این سنسور به هنگام توالی سنجی DNA به‌صورت زمان واقعی و بدون نشان‌دار شدن، جریان بیونی سنسور ثبت می‌شود و اطلاعات DNA با استفاده از تغییر این جریان در واحد زمان تفسیر می‌شود [۴۳].

#### نانوپورهای گرافن و توالی سنجی DNA:

این ایده که DNA با عبور از یک روزنۀ نانومتری بتواند بازهای سازنده‌اش خوانده شود و توالی آن‌ها در رشته DNA آنالیز گردد، از اوخر دهه ۱۹۸۰ مطرح شده است (شکل ۴). این تکنولوژی با سرعت، دقیقیت قابلیت انجام به‌صورت زمان واقعی را دارد [۴۴، ۴۵ و ۲۰، ۴۶]. از زمان معرفی نانوپورها تاکنون، به‌دلیل کاهش چشمگیر هزینه‌های آنالیز مواد بیولوژیکی و بیوشیمیابی در دنیا در زمینه تحقیقات، تحولی عظیم در حال وقوع است. در گرافن به‌دلیل ساختار ویژه شبکه‌اتمی که دارد، قابلیت ایجاد روزنۀ‌هایی با شکل منظم در ابعاد حدود چندده نانو در سطح آن توسط بمباران تحریک شده گرافن توسط باریکه الکترونی

35. Target-probe system  
36. Mismatch hybridize

37. Ethylenediamine (EDA)  
38. Gluteraldehyd (GA+)

39. Trifluoroethylamine (TFEA)  
40. Transverse Current


41. Source-Drain

ژنومها را در زمان اندک و با هزینه کم خواهد داد. این تکنولوژی، انقلابی عظیم در تکمیل پروردهای ژنومی خواهد بود. از آنجاکه براساس نقشه‌های راه تحقیقات جهانی، تکنولوژی پروب‌های فوتونیکی بر پایه گرافن در حال توسعه و یافتن کاربری‌های نوین هستند، بهنظر می‌رسد طب پزشکی، دارورسانی و درمان سرطان، متحول و طب پزشکی منحصر به بیمار<sup>۴۳</sup> گسترش خواهد یافت. براین اساس پیش‌بینی، تشخیص، درمان و پایش بیماری برای هر بیمار به صورت خاص آن بیمار طراحی و اجرا خواهد شد.

DNA جذب سطحی نانوپور می‌شود و همین امر سبب گرفتگی و بسته شدن نانوپور می‌شود. برای جلوگیری از چنین برهمکنشی، روش لایه‌نشانی هیدروفیلیک برای نانوپور پیشنهاد شده است تا با کمک این لایه‌نشانی از برهمکنش‌های هنگام عبور DNA و جذب سطحی شدن DNA در نانوپور و بسته شدن<sup>۴۲</sup> نانوپور جلوگیری به عمل آید.<sup>[۴۵]</sup>

#### آینده نانوسنسرهای گرافنی:

استفاده از آرایه‌های نانوپور گرافنی به محققان امکان توالی‌سنجی

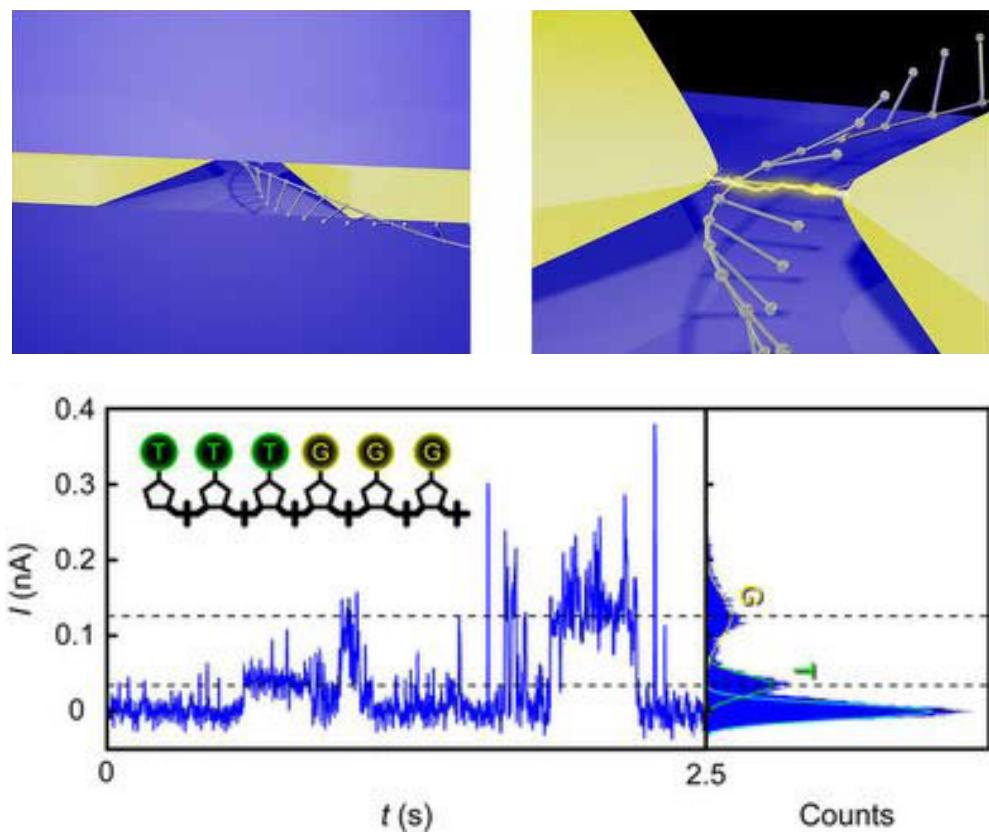

شکل ۵: منحنی جریان عرضی نانوپور به‌ازاء عبور بازهای نوکلئوتیدی DNA به‌هنگام توالی‌سنجی

## References:

1. Metzker LM. Emerging technologies in DNA sequencing, *Genomes Res*, 2005; 17:67-76.
2. Ken H. Nanopore-based single-molecule DNA analysis, *Nano medicine*, 2007; 2(4): 459-81.
3. Edwards MA, Henry RJ. DNA sequencing methods contributing to new directions in cereal research, *Journal of Cereal Science*, 2011; 54: 395-400.
4. Marziali A, Akeson M. New DNA Sequencing methods, *Annu. Rev Biomed Eng*. 2001; 3: 195–223.
5. Mingsheng X, Daisuke F, Nobutaka H. Perspectives and Challenges of Emerging Single-Molecule DNA Sequencing Technologies, *Small*, 2009; 5(23): 2638–49.
6. Kermit KM. DNA Sequencing by Mass Spectrometry, *Journal of Mass Spectrometry*, 1996; 31:1203-15.
7. Leandro S. New DNA sequencing technologies open a promising era for cancer research and treatment, *ClinTranslOncol*, 2011; 13: 301-6.
8. Kanigel R. The Genome Project, *New York Times Magazine*, December 1987; 99.
9. Morey M, Fernández-Marmiesse A, Castañeiras DM, Fraga J, Couce LM, Cocho JA. A glimpse into past, present, and future DNA sequencing, *Mol. Genet. Metab*, 2013; 1-22.
10. Neveling K, Collin R, Gilissen C, Van Huet R, Visser L, Kwint M, Gijsen S, Zonneveld M, Wieskamp N, Ligtenberg J, Siemiatkowska A, Hoefsloot L, Buckley M, Kellner U, Branham K, Den Hollander A, Hoischen A, Hoyng C, Klevering B, Van DB, Veltman J, Cremers F, Scheffer H. Next-generation genetic testing for retinitis pigmentosa, *Hum. Mutat*. 2012; 33: 963–72.
11. Pushkarev D, Norma FN, Stephen R Quake. Single-molecule sequencing of an individual human genome, *Nat Biotechnol*. 2009; 27(9): 847–50.
12. Kapranov P, Chen L, Dederich D, Dong B, He J, Steinmann KE, Moore AR, Thompson JF, Milos PM, Xiao W. Native molecular state of adeno-associated viral vectors revealed by single-molecule sequencing, *Hum. Gene Ther*. 2012; 23: 46–55.
13. David Edwards, Robert J, Henry and Keith J. Edwards. Preface: advances in DNA sequencing accelerating plant Biotechnology, *Plant Biotechnology Journal*, 2011; 10: 621–2.
14. Roach JC, Glusman G, Smit AF, Huff CD, Hubley R, Shannon PT, Rowen L, Pant KP, Goodman N, Bamshad M, Shendure J, Drmanac R, Jorde LB, Hood L, Galas DJ. Analysis of genetic inheritance in a family quartet by whole-genome sequencing, *Science* 2010; 328: 636–9.
15. Chiu RW, Sun H, Akolekar R, Clouser C, Lee C, McKernan K, Zhou D, Nicolaides KH, Lo YM. Maternal plasma DNA analysis with massively parallel sequencing by ligation for noninvasive prenatal diagnosis of trisomy 21, *Clin. Chem.* 2010; 56: 459–63.
16. KinLau T, Chen F, Pan Xi, Pooh RK, Jiang F, Li Y, Jiang H, Li X, Chen Sh, Zhang X. Noninvasive prenatal diagnosis of common fetal chromosome anomalies by maternal plasma DNA sequencing, *The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*, 2012; 25(8): 1370–4.
17. Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 1977; 74: 5463–7.
18. Pettersson E, Lundeberg J, Ahmadian A. Generations of sequencing technologies, *Genomics*, 2009; 93 : 105–11.
19. Choi M, Ute I, Schol I, Ji W, Liu T, Tikhonova RI. Genetic diagnosis by whole exome capture and massively parallel DNA sequencing, *PNAS*, 2009; 106 (45): 19096 –101.
20. Mardis E. The impact of next-generation sequencing technology on genetics, *Trends Genet*, 2008; 24: 133–41.
21. Levene MJ, Korlach J, Turner SW, Foquet M, Craighead HG, Webb W.W. Zero-mode waveguides for single-molecule analysis at high concentrations, *Science* 2003; 299: 682–6.
22. Novoselov KS, Falko VI, Colombo L, Gellert PR, Schwab MG, Kim K. A roadmap for graphene, *NATURE*, 2012; 490(192).
23. Shiekh AF. Personalized nanomedicine: future medicine for cancer treatment, *International Journal of Nanomedicine*, 2013; 8: 201–2.
24. Zhang XQ, Xu X, Bertrand N, Pridgen E, Swami A,

Farokhzad CO. Interactions of nanomaterials and biological systems: Implications to personalized nanomedicine, *Advanced Drug Delivery Reviews*, 2012; 64 :1363–1384 1365.

**25.** Yun Yeo-H, Eteshola E, Bhattacharya A, Dong Z, Shim JS, Conforti L, Kim D, Schulz MJ, Ahn CH, Nelson Watts. Tiny Medicine: Nanomaterial-Based Biosensors, *Sensors* 2009; 9: 9275-99.

**26.** Velasco-Garcia MN. Optical biosensors for probing at the cellular level: A review of recent progress and future prospects, *Seminars in Cell & Developmental Biology* 2009; 27–33.

**27.** Scheller FW, Schubert F, Pfeiffer D, Renneberg R. Intelligent Biosensors, *Annals New York Academy of Sciences*, 1987; 501: 240-8.

**28.** Fan XM, White I, Shopova IS, Zhu HD, Suter J, Sun Y. Sensitive optical biosensors for unlabeled targets: A review, *analytical Acta Chemica*, 2008; 620: 8–26.

**29.** Moerner WE. Proc. New directions in single-molecule imaging and analysis *Natl. Acad. Sci.* 2007; 104: 12596.

**30.** Bayley H. Holes with an edge, *NATURE*, 2010; 467: 164-7.

**31.** Novoselov KS, Falko VI, Colombo L, Gellert PR, Schwab MG, Kim K. A roadmap for graphene, *NATURE*, 2012; 490: 192-9.

**32.** Geim AK. Graphene: Status and Prospects, *Science* 2009; 324(5934): 1530-4.

**33.** Geim AK, Novoselov KS. The rise of graphene, *Nature Materials*, 2007; 6: 183-91.

**34.** Geim KA. Random Walk to Graphene, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2011; 50: 6967–85.

**35.** Novoselov SK. Graphene: Materials in the Flatland, *Angew. Chem. Int. Ed.* 2011; 50: 6986–7002.

**36.** Lee C, Wei X, Kysar JW, Hone J. Measurement of the elastic properties and intrinsic strength of monolayer graphene, *Science*. 2008; 321(5887): 385-8.

**37.** Bao Qi, Zhang H, Wang Y, Ni Z, Yan Y, Shen ZX, PingLoh K, Tang DY. Atomic-Layer Graphene as a Saturable Absorber for Ultrafast Pulsed Lasers, *Adv. Funct. Mater.* 2009; 19:1–7.

**38.** Kuila T. Recentadvances in graphene-based biosensors. *Biosens. Bioelectron.* 2011; 26: 4637–48.

**39.** Nair RR. Graphene as a transparent conductive support for studyingbiological molecules by transmission electron microscopy. *Appl. Phys. Lett.* 2010; 97: 153102.

**40.** Chen H, Muller MB, Gilmore KJ, Wallace GG, Li D. Mechanically strong, electrically conductive, and biocompatible graphene paper. *Adv Mater* 2008; 20(18): 3557.

**41.** Weibing Q, Wei Li, Xiaoqing Li, ChenXand XuD. Bioinspiredpolydopaminenanospheres: asuperquencher for fluorescence sensing ofbiomolecules, *Chem. Sci.*, 2014; 5: 3018.

**42.** Shijiang He, Song B, Di Li, Zhu Ch, Wenpeng Qi, Wen Y, Wang L, Song Sh, Fang H, Fan Ch. A GrapheneNanoprobe for Rapid, Sensitive, andMulticolor Fluorescent DNA Analysis, *Adv. Funct. Mater.* 2010; 20: 453–9.

**43.** Stine R, Robinson JT, Sheehan PE, Tamanaha CyR. Real-Time DNA Detection Using Reduced Graphene OxideField Effect Transistors, *Adv. Mater.* 2010; 22: 5297–300.

**44.** Peng Sh, Yang Zh, Xiang Ni, ZhangH, OuyangJ, FangpingO. DNA translocation through graphene nanopores: a first-principles study, *Mater. Res. Express*, 2014; 1(1).

**45.** Schneider GF, Xu Q, Hage S, Luik S, Spoor NHJ, Malladi S, Zandberge H, Dekker C. Tailoring the hydrophobicity of graphene for its use as nanopores for DNA translocation, *Nature communications*, 2013; 4.